

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

02-29634

No. 120207

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 東京支店 殿			機種	ONW-10
客先	所在地	東京都目黒区本町5-27-17			機番	000596
環営	ユーザー名	こんどう医院 様			納入日	平成17年7月19日
防品	点検者	中澤一裕	作業時間		受付日	平成23年12月5日
	返送先	納入先と同じ			出荷日	平成24年2月3日
計	3					

修理依頼・苦情内容

エラー11（サーミスタ異常）が出る。

不具合原因（故障箇所）と処置予定

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）


・エラー11

オゾン分解触媒を加熱するヒーターが故障し、これを温度センサー（サーミスタ）が検知してエラー11を発報しました。

故障したヒーターは新品に交換して復旧しました。

左上からヒーターASSY、吸湿筒、吸着筒

左下からドレンフィルター、オゾン分解触媒

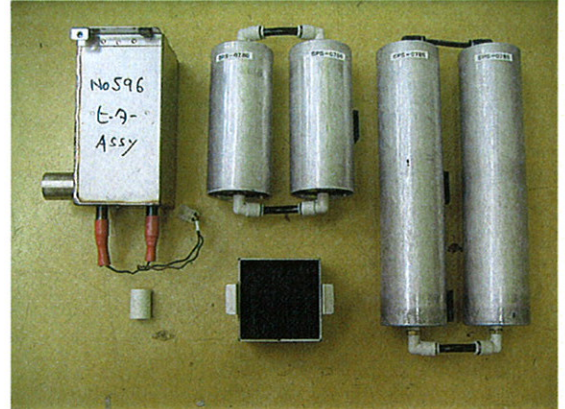

〔2〕修理・点検内容

・定期点検作業をした結果、正常であることを確認しました。

オゾン水濃度：0.49～0.62mg/L

酸素発生装置（PSA）

酸素濃度：93.1% 酸素流量：0.76L/min

圧力：0.075～0.140 MPa（AC100V、50Hz）

オゾンインジケータ変色・・・正常

・運転回数：4056回

—以上—

承認



審査



作成

H24.2.7

中澤

推奨 交換 部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	ヒーターASSY	1個	
	吸着筒、吸湿筒	1式	定期交換部品
	オゾン分解触媒	1個	定期交換部品
	ドレンフィルター	1個	定期交換部品