

船橋市 井上クリニック OED1000 2015 8/17点検状況

異常履歴について 最近水温が高くなり異常が出ているとのこと。

↓ 点検時異常履歴

Date	Time	Error	Ct
08/05	09:42	停電 (E:403)	1
09/27	14:45	濃度維持異常 (E:302)	2
11/26	12:27	殺菌時給水異常 (E:202)	13
11/26	12:41	殺菌時給水異常 (E:202)	13
12/12	11:08	酸素圧力異常2 (E:200)	8
02/20	14:05	排水異常2 (E:402)	3
03/13	10:05	排水異常2 (E:402)	3
04/08	14:24	殺菌槽異常 (E:101)	2
05/19	14:05	殺菌時給水異常 (E:202)	13
07/07	16:00	殺菌時給水異常 (E:202)	13


Date	Time	Error	Ct
10/04	12:16	酸素圧力異常2 (E:200)	8
10/08	14:22	殺菌時給水異常 (E:202)	13
12/14	14:06	殺菌時給水異常 (E:202)	13
12/14	14:35	殺菌時給水異常 (E:202)	13
12/28	10:29	酸素圧力異常2 (E:200)	8
03/15	12:59	殺菌時給水異常 (E:202)	13
06/09	10:28	酸素圧力異常2 (E:200)	8
06/18	14:49	ろ過水生成異常 (E:207)	4
07/30	11:08	殺菌時給水異常 (E:202)	13
08/05	09:42	停電 (E:403)	1

一番新しい異常データ

Date	Time	Error	Ct
04/05	13:22	殺菌時給水異常 (E:202)	13
04/05	13:54	水位低下異常 (E:300)	1
07/12	15:00	酸素圧力異常2 (E:200)	8
08/06	15:34	原水汚れ異常 (E:209)	1
08/06	15:41	光量低下異常1 (E:210)	3
08/06	15:41	ろ過切れ異常 (E:212)	2
08/06	15:47	光量低下異常1 (E:210)	2
08/06	16:30	光量低下異常1 (E:210)	3
08/06	16:30	ろ過切れ異常 (E:212)	2
10/04	12:16	酸素圧力異常2 (E:200)	8

Date	Time	Error	Ct
05/08	15:30	酸素圧力異常2 (E:200)	8
05/19	09:47	排水異常2 (E:402)	3
08/15	09:38	殺菌槽異常 (E:101)	2
08/21	13:52	ろ過水生成異常 (E:207)	4
08/21	14:04	濃度維持異常 (E:302)	2
08/27	09:46	ろ過水生成異常 (E:207)	4
10/01	09:37	殺菌時給水異常 (E:202)	13
10/12	14:21	酸素圧力異常2 (E:200)	8
04/05	13:22	殺菌時給水異常 (E:202)	13
04/05	13:54	水位低下異常 (E:300)	1

分岐蛇口のcockが故障している。(蛇口を閉めてもOED側に水が流れる＝OED故障時の入れ替えが出来ない)

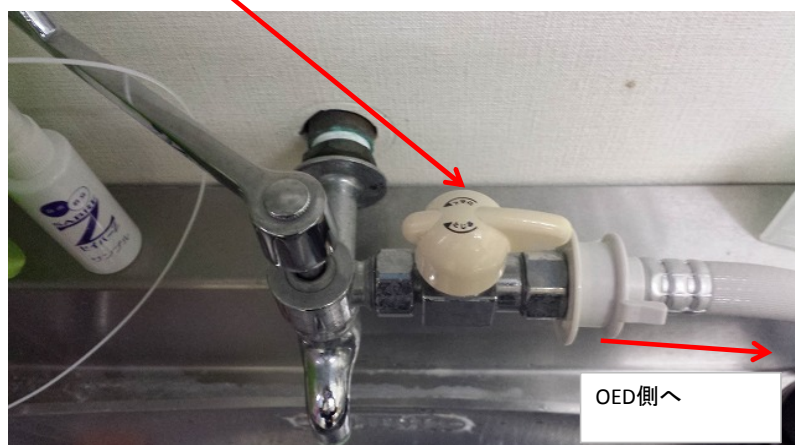

※ユーザーの水道工事業者で、点検してもらうように指示した。