

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20180116
発行日：平成 30 1月 16 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	製造番号： 100232
作業年月日	平成 30 年 1 月 10 日	作業時間： Hr
顧客名	みずほ台病院 様	TEL： 0492-52-5121
所在地	埼玉県富士見市西みずほ台2-9-5	ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	平成 23 年 7 月 26 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・ <u>引取</u>	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☒	

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
定期保守点検 および オーバーホール			
不具合原因、作業内容			
ポンプ類、電磁弁、配管チューブなど、主要部品を交換いたしました。			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ ハル数 428
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
作業結果 (<u>完了</u> 、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			
・交換部品の詳細は別紙「100232号 工事写真」をご参照ください。			
・タッチパネルを交換しましたが、操作上の変更はありません。			

装置 情報	交換後運転回数：2187→5	更新 (リセット) <u>実施</u> ・未実施	殺菌/消毒： 6142	殺菌/消毒+アル： 5580
	リークチェック： 107	自己洗浄： 1791	アルコール単独： 173	エア単独： 27

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
定期交換部品		☒	1 式	酸素、給水電磁弁		☒	1 式
メイン、排水、エアポンプ		☒	1 式	アルコールライン電磁弁		☒	1 式
排気ファン		☒	1 台	配管パッキン、フタパッキン		☒	1 式
ドレンバルブ ASSY		☒	1 式	タッチパネル (カラー型)		☒	1 式
マニホールド 電磁弁		☒	1 式	トレ ASSY		☒	1 式

お客様ご確認署名欄	年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
工場点検につき不要です	
ご署名	印

修理業者 株式会社 IHI アグリテック (旧社名 IHI シパウラ)
岡山県岡山市東区西大寺新地 1 7 0 - 6
TEL:086-944-6528

責任技術者	作業者

1: 定期交換部品 一式









2: ポンプ類、ドレンバルブASSY、マニホールド電磁弁、酸素、給水電磁弁、アルコールライン電磁弁



3: 配管パッキン、フタパッキン、タッチパネル、トレイASSY



No.M-17-001		御見積書		岡-17-0270						
みずほ台病院 御中 下記の通りお見積もりいたしますので 何卒ご用命くださいますようお願い申し上げます。		平成29年12月5日 株式会社 IHIアグリテック 環境事業部 サービスグループ 岡山県岡山市東区西大寺新地170番6 TEL 086-944-6528 FAX 086-942-9030								
		件名: 内視鏡殺菌機 OED-1000 オーバーホール								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">御見積金額</td> <td style="width: 50%; padding: 5px; text-align: right;">¥404,220</td> </tr> </table>		御見積金額	¥404,220	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">承認 </td> <td style="width: 33%; text-align: center;">審査 </td> <td style="width: 33%; text-align: center;">作成 </td> </tr> </table>				承認 	審査 	作成 
御見積金額	¥404,220									
承認 	審査 	作成 								
御支払条件 : 貴社慣行払い 納入場所 : 貴社指定場所 見積有効期限 : 発行後3ヶ月		伝票No. : 02-54214 受付日 : 平成29年11月27日 貴社名 : 新鋭工業(株) 東京支店殿 顧客名 : みずほ台病院 様 機種名 : OED-1000 100232号								
No	品名	摘要	個数	単位	単価	見積金額				
1	定期交換部品	保守点検	1	式	70,000	70,000				
2	メインポンプ		1	台	72,000	72,000				
3	排水ポンプ		1	台	24,460	24,460				
4	エアポンプ		1	台	19,250	19,250				
5	排気ファン		1	台	6,720	6,720				
6	ドレンバルブASSY	DCモータ、カム含む	1	式	17,610	17,610				
7	マニホールド電磁弁	SV 6~13	1	式	48,090	48,090				
8	酸素電磁弁	SV15~16	1	式	26,620	26,620				
9	給水電磁弁	SV 4~5	2	個	8,400	16,800				
10	アルコールライン電磁弁	SV14	1	個	7,170	7,170				
11	配管パッキン、フタパッキン		1	枚	15,000	15,000				
12	タッチパネル 色や式 パネル	カラー型 特別価格 ¥7万	1	台	10,000	10,000				
13	トレイASSY		1	枚	22,500	22,500				
14						0				
15						0				
16						0				
					小計	356,220				
17	分解点検、部品取付		5	H	9,000	45,000				
18	運転検査・清掃	保守点検作業に含む	0	H	9,000	0				
					小計	45,000				
19	送料		1	式	3,000	3,000				
					小計	3,000				
定価					合計	404,220				

備考: 1. 本見積には消費税は含まれておりません。

2. 新たに部品の交換が発生した場合は別途お見積もりさせていただきます。

発 注 書


上記見積もり内容にて発注いたします。

ご署名

TEL

 12月15日
 みずほ台病院
 総務課 課長 印

049-252-5123

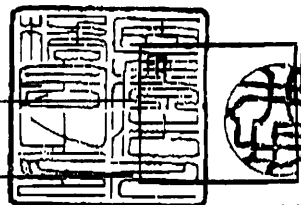

水槽 樹脂製 14万位 清掃あり 見送り