管理 No.　20211028

保守点検・修理　報告書

発行日：2021年　10　月　28　日

販 売 名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ■		製造番号： 300017
作業年月日	令和　3　年　10　月　26　日		作業時間：　Hr
顧 客 名	いいぬまクリニック　様		TEL： 0463-89-1555
所 在 地	神奈川県秦野市堀川175-4		ご担当　様
販 売 店			ご担当　様
納入年月日	2013年　3　月　7　日	保証期間　内 □　外 □	付属品
作業区分	保守点検 □　総合点検 ■　年　回目		定期点検ｼｰﾙ記入 □
引取	修　理 □　点検のみ □　その他 □		修理表示貼付 ■

不具合状況、依頼内容

起動不良修理およびオーバーホール

不具合原因、作業内容

修理 および オーバーホールを実施いたしました。

点検項目

フタロック	正常 ■	殺菌槽 ＬＥＤ	正常 ■
酸素ライン	正常 ■	エアライン	正常 ■
アルコールライン	正常 ■	オゾン水濃度計動作	正常 ■　ﾊﾟﾙｽ数 463
オゾンセンサ	正常 ■	排水栓、排水ライン	正常 ■
給水ライン	正常 ■	細管送水ライン	正常 ■
濃度計流量	正常 ■	排気ライン	正常 ■
水位センサー	正常 ■	オゾン濃度	正常 ■　履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ■	異常音、振動	正常 ■
清掃	正常 ■　清掃 ■	電源コード	正常 □
トレー	正常 ■	殺菌チューブ類	正常 □
殺菌槽コネクタ	正常 ■	マニホールド周辺ﾁｭｰﾌﾞ	正常 ■
	□	運転ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾊﾞｰｼﾞｮﾝ	正常 ■　Ver.0209/T05C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ありませんでした。

装置情報							
交換後運転回数：539	更新（ﾘｾｯﾄ）・・未実施		殺菌/消毒： 9026		殺菌/消毒＋ｱﾙ： 0		
リークチェック： 0	自己洗浄： 3144		ｱﾙｺｰﾙ単独： 0		エア単独： 0		

交換部品名称	見積部品No	交換	数量		交換部品名称	見積部品No	交換	数量
24V電源	1	■	1台		ﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ電磁弁	7	■	1式
コントロール基板	2	■	1式		酸素電磁弁	8	■	1式
メインポンプ	3	■	1式		給水電磁弁	9	■	2個
排水ポンプ	4	■	1台		ｱﾙｺｰﾙﾗｲﾝ電磁弁	10	■	1個
排気ファン	5	■	1台		配管ﾊﾟｯｷﾝ、ﾌﾀﾊﾟｯｷﾝ	11	■	1式
ドレンバルブASSY	6	■	1式		水槽	12	■	1式

機械出荷日：2021年10月26日

責任技術者	作業者
中 '21.10.28 澤	宮宗

修理業者　株式会社 ＩＨＩ物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地１７０－６
TEL:086-944-6528

Ver.3.2

OED-1000S　機番:300017号 工事写真

20211028:別紙

1:メインポンプ、排水ポンプ、排気ファン、DCモータ、マニホールド電磁弁(ブロック、アスピレータ含む)

給水電磁弁、酸素電磁弁、アルコールライン電磁弁、24V電源

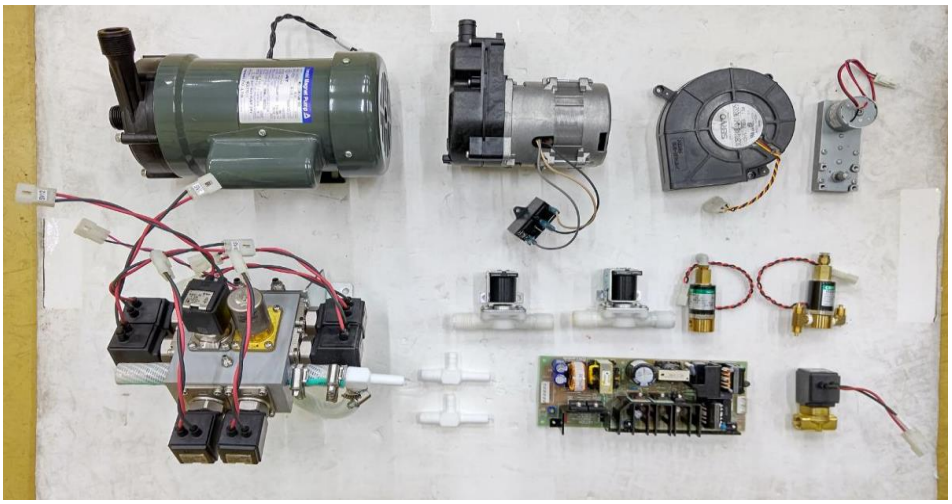

2:フタパッキン、コントロール基板

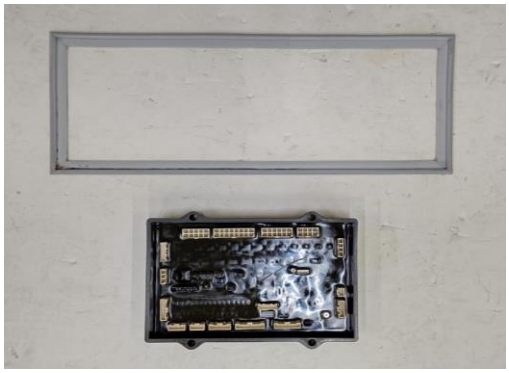

3:水槽

4:ドレンバルブASSY、配管パッキン、カム