

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20190722

発行日 令和元年 7月 22日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100133
1: 修理部品	令和 元年 7月 20日		作業時間:	Hr
顧客名	織内医院 様		TEL:	0246-44-1133
所在地	福島県いわき市常磐関船町迎16		担当	
販売店			担当	様
納入年月日	2010/12/14	保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/>	付属品	
作業区分	保守点検 <input type="checkbox"/>	総合点検 <input type="checkbox"/>	年 回目	定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>
出張・引取	オーバーホール <input checked="" type="checkbox"/>			修理表示貼付 <input checked="" type="checkbox"/>

不具合状況、依頼内容	レベルセンサー異常の修理 および 他点検
------------	----------------------

不具合原因、作業内容	水位レベルセンサの検知感度が鈍くなっており、これが原因で「レベルセンサー異常 (E:214)」が発生しました。この部品交換のほか、オーバーホールを実施いたしました。
------------	--

点検項目			
フタロック	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	殺菌槽 LED	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
酸素ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	エアライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
アルコールライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン水濃度計動作	正常 <input checked="" type="checkbox"/> ハルス数 479
オゾンセンサ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排水栓、排水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
給水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	細管送水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
濃度計流量	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排気ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
水位センサー	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン濃度	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.67 ppm
水漏れ確認	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	異常音、振動	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
清掃	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/>	電源コード	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
トレイ	正常 <input type="checkbox"/>	殺菌チューブ類	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
殺菌槽コネクタ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	マニホールド周辺チューブ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	・交換部品の詳細は別紙「100133号 工事写真」をご参照ください。
----------------------------	------------------------------------

装置情報	交換後運転回数: 416	更新 (リセット) 実施 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 <input type="checkbox"/>	殺菌: 6118	殺菌+アル: 3329
	リークチェック: 2225	自己洗浄: 1815	アルコール単独: 267	エア単独: 4


交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
水位レベルセンサ		<input checked="" type="checkbox"/>	1 式	マニホールド電磁弁		<input checked="" type="checkbox"/>	1 式
コントロール基板		<input checked="" type="checkbox"/>	1 式	酸素、給水電磁弁		<input checked="" type="checkbox"/>	1 式
メインポンプ、排水ポンプ		<input checked="" type="checkbox"/>	1 式	アルコールライン電磁弁		<input checked="" type="checkbox"/>	1 式
エアポンプ		<input checked="" type="checkbox"/>	1 台	配管パッキン、フタパッキン		<input checked="" type="checkbox"/>	1 式
ドレンバルブ ASSY		<input checked="" type="checkbox"/>	1 式			<input type="checkbox"/>	

機械受付日: 令和元年 6月 7日
機械出荷日: 令和元年 7月 20日

修理業者 株式会社 IHI アグリテック 岡山事業所
 岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
 TEL: 086-944-6528

責任技術者	作業者
	2019/7/20 中澤

1: 修理部品 水位レベルセンサ、コントロール基板

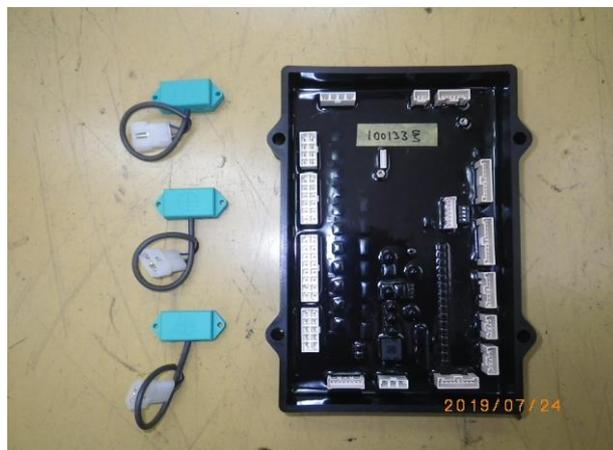

2: メインポンプ、排水ポンプ、エアポンプ、ドレンバルブASSY



3: マニホールド電磁弁、酸素電磁弁、給水電磁弁、アルコールライン電磁弁、配管パッキン、フタパッキン

