点検、整備報告書

2016 年 5 月 23 日

毎々格別のご高配を賜りお礼申し上げます。
装置の点検、整備結果につきまして下記にご報告いたします。

株式会社ＩＨＩシバウラ
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
電話：086-944-6528

配布先	
客　先	1
環営メ	1
環　品	1
計	3

納 入 先	株式会社　モリタ　福岡支店　様	機　　種	IC Clave
顧 客 名	イルカ歯科　　様	機　　番	100022
所 在 地	長崎県諫早市栄町 9-2	納　入　日	2015 年 12 月 1 日
作 業 者	安田、西村	受　付　日	2016 年 4 月 27 日
返 送 先	エムシーサービス株式会社　北九州ＳＣ	発　送　日	2016 年 5 月

点検、処置内容

［１］依頼内容・症状

エラーNo.１５　「蒸気発生器加熱時間オーバー異常」

工場で確認したところ、異常は再現しました。

原因

蒸気発生器のヒータが故障しており、これが原因で所定の温度に上がりませんでした

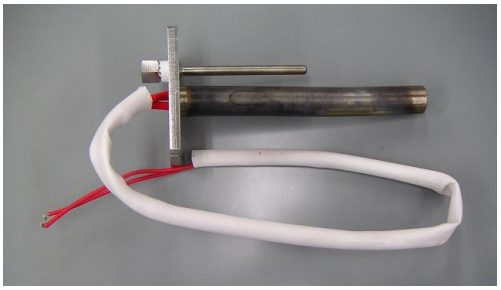

［２］作業内容

・部品交換、調整（写真と下表をご参照ください）

・運転確認・・134℃ Long　１回、デンタルモード　３回・・正常終了

［３］運転回数

エアフィルタ：381/400　　ドアパッキン：384/1000　　定期メンテ：384/1000
プログラムバージョン：TY.001.22

承 認
安田
責任技術者
富田
作 成
中澤

その他

附属品；　本体のみ

交 換 部 品

部品番号	部品名称	数量	備　考

D 作業報告書

お客様	イルカ歯科医院 様	ご承認印			
住所	長野県諏訪市栄町9-2				
TEL	0957-22-3503	客先		担当	様
機種型式	IC Clave	号機		運転回数	回
完了	継続	有料	無料	製番	100022
取扱業者名	様	ご担当者	様		

作業日 20 16 年 5 月 25 日

定期点検	1 保守契約	2 性検 整備	3 性検 三検	4 点検 整備	5 点検	9 修理外	(該当に✓)
サービス形態	1 保守期間	2 スポット	3 CM	医療機器		区分	特管 / 非特管

作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 ロム	60 法定整備
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 EC	80 アフター	90 その他

(24時制で記入)

	月	日	時	分
受付時間				
出発時間				
到着時間				
作業完了時刻				

メモ

特記事項
請求:IHエンバウラ

①管理No. 781965
②作業日 20 160525
③Cコード 095722350 3
④⑤機種コード 11 - 09
⑤製造No. 100022
⑦保守・サービス形態 作業区分 9 - 2 - 50
⑧故障コード 32 - - - -
⑨実施SC 66
⑩技術者 37
⑪同行・応援
⑫原因・処理 - - - 2

ご依頼内容・現象
エラー15(蒸気発生器加熱時間オーバー異常)
&警報発生に伴う修理

原因
蒸気発生器のヒーター故障の為

処置
・IHエンバウラ様により引取り修理及び貸替器と取替え。
・IHエンバウラ様にて修理。(後日報告)
・修理完了品と貸替器入替作業。
・耐圧テスト、リークテスト実施。

最終確認チェック
□汚れ □行程異常 □異音・異臭 □安全装置動作
□発錆 □プログラム設定 □試運転 □最終検査終了

お客様への伝言

隣の機器のコンディション
メーカー
機種
□異常なし □警報・ロ
□漏れあり □異音あり
□破損あり □劣化あり
部位

□見積添付 あり なし

コード	交換部品・機材名称	数量	単位	金額

A

1	基本・垣付・点検・性検・ (見積書No.)	
2	技術料 7.5 H× 1 名×7,500円	11,250
3	派遣料 往復 380 km× 1 名× 100 円	38,000
4	宿泊費 泊× 名× 円	
5	諸経費	3,000
6	高速料金(小諸↔諏早)	8,820

B

精算内訳

⑬A 部品代
⑭B 技術料等 61,070
⑮
⑯ 税込合計金額 61,070
消費税 4,885
ご請求金額等 65,955
納品書No. 1697

サービスセンター 北九州
実施者 久岡
TEL - -

部署長	入力	検印	納品書
営業部	小林	長川原	久保

エムシーサービス株式会社 〒387-0013長野県千曲市小島3171-5 TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074 お問い合せは右上の管理No.にてお願いします。

D 実施者→経理→営業