

No.M-18-199

## 御見積書

岡-18-140

2018年7月31日

新鋭工業株式会社  
名古屋支店 ご担当者 様

下記の通りお見積もりいたしますので  
何卒ご用命くださいますようお願い申し上げます。

株式会社 IHIアグリテック  
環境プロジェクト部 サービスグループ  
岡山県岡山市東区西大寺新地170番6  
TEL 086-944-6528  
FAX 086-942-9030

件名: eZ-100 点検・修理

御見積金額

¥96,000

| 課長 | 審査 | 作成 |
|----|----|----|
| 若井 | 若井 | 富田 |

御支払条件 : 貴社慣行払い  
納入場所 : 貴社指定場所  
見積有効期限 : 発行後3ヶ月

伝票No. :  
受付日 : 2018年7月25日  
貴社名 : 協和医科器械株式会社 様  
顧客名 : 岡崎市民病院 様  
機種名 : eZ-100 / 010133号機 2009年11月製造

| No              | 品名               | 摘要 | 個数    | 単位 | 単価     | 見積金額    |
|-----------------|------------------|----|-------|----|--------|---------|
| 1-1             | DCブローア           |    | 1     | 個  | 44,800 | 44,800  |
| 1-2             | ボウシンゴム           |    | 1     | 枚  | 660    | 660     |
| 1-3             | リモコン             |    | 1     | 個  | 7,800  | 7,800   |
| 1-4             | 定期交換部品           |    | 1     | 式  | 44,300 | 44,300  |
|                 |                  |    |       |    |        |         |
|                 |                  |    |       |    |        |         |
|                 |                  |    |       |    |        |         |
|                 |                  |    |       |    | 小計     | 97,560  |
| 2-1             | 部品交換工賃           |    | 1     | H  | 9,000  | 9,000   |
| 2-2             | 内外部点検・調整・運転検査・清掃 |    | 1     | H  | 9,000  | 9,000   |
|                 |                  |    |       |    |        |         |
|                 |                  |    |       |    |        |         |
|                 |                  |    |       |    |        |         |
|                 |                  |    |       |    | 小計     | 18,000  |
| 3-1             | 送料               |    | 1     | 式  | 1,500  | 1,500   |
| 3-2             | 作業準備費            |    | 0.5   | H  | 9,000  | 4,500   |
| 3-3             | 作業報告書作成費         |    | 1     | 式  | 2,000  | 2,000   |
|                 |                  |    |       |    |        |         |
|                 |                  |    |       |    | 小計     | 8,000   |
| 4-1             | 値引               |    |       |    |        | ▲ 3,560 |
|                 |                  |    |       |    |        |         |
| 同梱品: リモコン・電源コード |                  |    |       |    |        |         |
| 定価              |                  |    |       |    | 合計     | 120,000 |
| 仕切価格            |                  |    | ×0.80 |    |        | 96,000  |

備考: 1. 本見積には消費税は含まれておりません。  
2. 新たに部品の交換が発生した場合は別途お見積もりさせていただきます。

## 発 注 書

上記見積もり内容にて発注いたします。 月 日

ご署名

TEL

印

## F A X 連 絡 書

30 年 8 月 31 日

株式会社 IHIアグリテック 御E

ご担当者 様

新鋭工業株式会社

FAX:086-942-9030

愛知県名古屋市昭和区石仏町2丁目

1-40 グランカーサ御器所

TEL:052-859-1333

FAX:052-859-1334

担当:杉浦

拝啓 貴社ますますご清栄のことと御慶び申し上げます。日頃は大変お世話になっております。  
さて、下記の件につきましてFAXにてご送付いたしますので、宜しくお願い致します。

敬具

件名 修理品の件

いつもお世話になっております。

早速ですが、下記内容で修理品の処理をお願い致します。

|          |          |
|----------|----------|
| 当社修理荷札番号 | なし       |
| 製品名      | EZ-100   |
| 製造番号     | 010133   |
| 御社見積番号   | 岡-18-140 |
| 御社受付番号   |          |
| ユーザー名    | 岡崎市民病院様  |

修理開始

未修理返却

廃棄処分

をお願い致します。

宜しくお願い致します。

# 点検、整備報告書

毎々格別のご高配を賜りお礼申し上げます。

装置の点検、整備結果につきまして下記にご報告いたします。

2018年9月14日

株式会社 I H I アグリテック

|     |   |       |                    |       |                     |
|-----|---|-------|--------------------|-------|---------------------|
| 配布先 |   | 納入先   | 新鋭工業株式会社 名古屋支店 様   | 機 種   | e Z - 1 0 0         |
| 客 先 | 1 |       |                    |       |                     |
| 環営メ | 1 | 代理店名  | 協和医科器械株式会社 岡崎営業所 様 | 機 番   | 0 1 1 0 1 3 3       |
| 環 品 | 1 |       |                    |       |                     |
|     |   | 顧 客 名 | 岡崎市民病院 様           | 製造年月日 | 平成 21 (2009) 年 11 月 |
|     |   |       |                    |       |                     |
|     |   | 修 理 者 | 富 田                | アワメータ |                     |
|     |   |       |                    |       |                     |
| 計   | 3 | 返 送 先 | 新鋭工業株式会社 名古屋支店 様   | 発 送 日 | 2018 年 9 月 14 日     |

## 点検、処置内容

### [1] 依頼内容・症状と点検結果・処置

(依頼内容・症状) (受取日 2018 年 7 月 25 日 )

点検・劣化部品交換。

(点検結果・処置)

1. D C ブロアー (循環ファン) が作動時に若干異音が発生していました。  
ファン部の回転軸の摩耗が原因と思われます。今後摩耗が進行すると不快な音に変わりますので、D C ブロアーの交換を行いました。  
ボウシゴムは、再利用出来ない事から、新規貼り付けとなります。
2. リモコンは、電池の液漏れにより故障していましたので、交換しました。
3. 定期交換部品は、一式交換しました。

### [2] 運転検査

1. 吸引運転作動確認・・・・・・正常  
流量 7.0 L/min オゾン濃度 19 ppm オゾン発生量 17.0 mg/ h (規格 15 mg/ h)
2. くん蒸運転作動確認・・・・・・正常  
流量 15.0 L/min オゾン濃度 350 ppm オゾン発生量 675 mg/ h (規格 540 mg/ h 以上)
3. 絶縁抵抗・耐電圧試験・・・・合格

## その他

附属品 ; リモコン (新品) ・ 電源コード

## 交 換 部 品

|                         |      |          |     |     |
|-------------------------|------|----------|-----|-----|
| 承認<br>若<br>18.9.14<br>井 |      |          |     |     |
| 審査<br>若<br>18.9.14<br>井 | 部品番号 | 部品名称     | 数量  | 備 考 |
| 作成<br>富<br>18.9.14<br>田 |      | D C ブロアー | 1 個 |     |
|                         |      | ボウシゴム    | 1 枚 |     |
|                         |      | リモコン     | 1 個 |     |
|                         |      | 定期交換部品   | 1 式 |     |
|                         |      |          |     |     |
|                         |      |          |     |     |



## F A X 連 絡 書

30 年 8 月 31 日

株式会社 IHIアグリテック 御E

ご担当者 様

新鋭工業株式会社

FAX:086-942-9030

愛知県名古屋市昭和区石仏町2丁目  
1-40 グランカーサ御器所

TEL:052-859-1333

FAX:052-859-1334

担当:杉浦

拝啓 貴社ますますご清栄のことと御慶び申し上げます。日頃は大変お世話になっております。  
さて、下記の件につきましてFAXにてご送付いたしますので、宜しくお願い致します。

敬具

件名 修理品の件

いつもお世話になっております。

早速ですが、下記内容で修理品の処理をお願い致します。

|          |          |
|----------|----------|
| 当社修理荷札番号 | なし       |
| 製品名      | EZ-2000  |
| 製造番号     | 011505   |
| 御社見積番号   | 岡-18-142 |
| 御社受付番号   |          |
| ユーザー名    | 岡崎市民病院様  |

修理開始

未修理返却

廃棄処分

をお願い致します。

宜しくお願い致します。

# 点検、整備報告書

毎々格別のご高配を賜りお礼申し上げます。  
装置の点検、整備結果につきまして下記にご報告いたします。

2018年9月14日  
株式会社 I H I アグリテック

|     |   |       |                    |       |                    |
|-----|---|-------|--------------------|-------|--------------------|
| 配布先 |   | 納入先   | 新鋭工業株式会社 名古屋支店 様   | 機 種   | e Z - 2 0 0 0      |
| 客 先 | 1 |       |                    |       |                    |
| 環営メ | 1 | 代理店名  | 協和医科器械株式会社 岡崎営業所 様 | 機 番   | 0 1 1 5 0 5        |
| 環 品 | 1 |       |                    |       |                    |
|     |   | 顧 客 名 | 岡崎市民病院 様           | 製造年月日 | 平成 22 (2010) 年 1 月 |
|     |   |       |                    |       |                    |
|     |   | 修 理 者 | 富 田                | アワメータ |                    |
|     |   |       |                    |       |                    |
| 計   | 3 | 返 送 先 | 新鋭工業株式会社 名古屋支店 様   | 発 送 日 | 2018 年 9 月 14 日    |

## 点検、処置内容


### [1] 依頼内容・症状と点検結果・処置

(依頼内容・症状) (受取日 2018年7月25日 )

点検・劣化部品交換。

(点検結果・処置)

1. 定期交換部品は、一式交換しました。

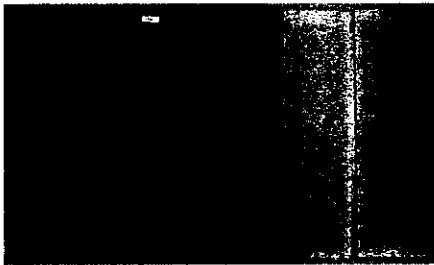

交換した定期交換部品

左側：フィルターキット

右側：プレフィルター 2枚

2. その他の箇所では、特に不具合は見受けられませんでした。

### [2] 運転検査

1. 吸引運転作動確認・・・正常  
オゾン発生量 (吸引オゾンナイザー)  
流量 8.0 L オゾン濃度 19 ppm オゾン発生量 19.5 mg/ h (規格 15 mg/ h)
2. くん蒸運転作動確認・・・正常  
オゾン発生量  
流量 16.0 L オゾン濃度 340 ppm オゾン発生量 704 mg/ h (規格 630 mg/ h 以上)
3. 絶縁抵抗・耐電圧試験・・・合格

## その他

承認  
若  
18.9.14  
井  
附属品；リモコン・電源コード

## 交換部品

|                   |                |        |     |    |
|-------------------|----------------|--------|-----|----|
| 承認                | 附属品；リモコン・電源コード |        |     |    |
| 若<br>18.9.14<br>井 | 交換部品           |        |     |    |
| 審査                | 部品番号           | 部品名称   | 数量  | 備考 |
| 若<br>18.9.14<br>井 |                | 定期交換部品 | 1 式 |    |
|                   |                |        |     |    |
|                   |                |        |     |    |
| 作成                |                |        |     |    |
|                   |                |        |     |    |
| 富<br>18.9.14<br>田 |                |        |     |    |

元払

福山通運

荷物領収原票

18年 9月 14日

(052)859-1333  
お 愛知県名古屋市昭和区  
届 石仏町2-1-40  
け  
先 新鋭工業株式会社 名古屋支店  
杉浦様

受領印

様

(086)944-6510  
岡山県岡山市東区  
西大寺新地170番6  
㈱IHIアグリテック

H3000-067  
EZ-100  
010133号機  
EZ-2000  
010505号機  
点検・修理完了機  
岡崎市民病院様  
サービスG 富田

お問い合わせ番号: 77-8334-1322



90kg

a 778334132201a 発店 517 2個口

ドライバーのカマ、この荷物は送り状兼用（領収原票）です

(052)859-1333  
お 愛知県名古屋市昭和区  
届 石仏町2-1-40  
け  
先 新鋭工業株式会社 名古屋支店  
杉浦様

000049

3-24

様

(086)944-6510  
岡山県岡山市東区  
西大寺新地170番6  
㈱IHIアグリテック

H3000-067  
EZ-100  
010133号機  
EZ-2000  
010505号機  
点検・修理完了機  
岡崎市民病院様  
サービスG 富田

お問い合わせ番号: 77-8334-1322



a 778334132201a 発店517 No. 4132

1 / 2 個

荷 札 元払

18年 9月 14日

福山通運

(052)859-1333  
荷 愛知県名古屋市昭和区  
受 石仏町2-1-40  
人 新鋭工業株式会社 名古屋支店  
杉浦様

000049

B4660023B  
18年 9月 14日

福山通運

3-24

発店: 517 元



A 778334132202A

岡山県岡山市東区  
荷 西大寺新地170番6  
送 ㈱IHIアグリテック  
人 11  
(086)944-6510

個 数  
2/2  
NO.4132

H3000-067  
EZ-100  
010133号機  
EZ-2000  
010505号機  
点検・修理完了機  
岡崎市民病院様  
サービスG 富田

荷 札